




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЭТАЛОН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 1 — 200 МГц

ГОСТ 8.412-81

Издание официальное

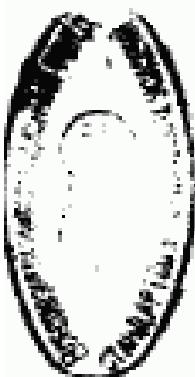

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Л. Н. Иващенко (руководитель темы), Ю. И. Малыхин, А. А. Михайленко

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л. К. Исаев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 марта 1981 г. № 159

Редактор Е. И. Глазкова

Технический редактор В. Е. Трусакова

Корректор А. Г. Гин

Сдано в наб. 25.03.81 Подп. в печ. 08.05.81 0,3

32 уч.-изд. л. Тираж 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов
Тип. «Московский печатник». М.

12557, Москва, Новокрасненский пер., 3
Печат. зерн., б. Зав. 707

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**Государственная система обеспечения
единства измерений**
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 1÷200 МГц**

*State system for ensuring the uniformity
of measurements. State special standard and state
verification schedule for means measuring relative
dielectric constant at frequency 1÷200 MHz*

**ГОСТ
8.412—81**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 марта 1981 г. № 159 срок введения установлен

с 01.07 1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц и устанавливает назначение государственного специального эталона единицы относительной диэлектрической проницаемости — относительной единицы — в диапазоне частот 1÷200 МГц, комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц от государственного специального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный эталон

1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц и передачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц должна быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1981

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

мера относительной диэлектрической проницаемости;
компаратор (установка типа КДПР).

1.1.4. Номинальное значение относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц, воспроизводимое эталоном, составляет 1,0006 относительной единицы.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений S_0 , не превышающим $3 \cdot 10^{-4}$. Неисключенная систематическая погрешность Θ_0 не превышает $5 \cdot 10^{-4}$.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для передачи размера единицы относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц вторичным эталонам сличением при помощи компаратора.

1.2. Вторичные эталоны

1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы средств измерений, состоящие из набора мер со значением относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне 2÷10 и компаратора.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличений рабочих эталонов со специальным эталоном должны быть не более $3 \cdot 10^{-3}$ в диапазоне частот 1÷200 МГц для материалов с тангенсом угла диэлектрических потерь не более $5 \cdot 10^{-2}$.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера единицы образцовым средствам измерений сличением при помощи компаратора и рабочим средствам измерений повышенной точности методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют стандартные образцы относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне 2÷20.

2.2. Доверительные относительные погрешности δ_0 образцовых средств измерений (при доверительной вероятности 0,95) должны быть не более 0,9%.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки рабочих средств измерений методом прямых измерений и сличением при помощи компаратора.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют приборы, основанные на мостовых, резонансных, генераторных и интерференционных схемах; образцы диэлектрических материалов для контроля технологических процессов и рабочие средства измерений повышенной точности.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Δ_0 рабочих средств измерений составляют от 0,5 до 5%.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 1÷200 МГц**

